

BỘ Y TẾ
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Số: 165/VXSPYT-VT

V/v: Đề nghị báo giá lọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Địa chỉ: 09 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

Kính gửi: Các công ty,

Để phục vụ cho việc sản xuất vắc xin và sinh phẩm, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cần mua lọc (*Chi tiết xem trong Phụ lục đính kèm*).


Yêu cầu:

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về yêu cầu kỹ thuật.
- Báo giá xin gửi về Phòng Vật tư – Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế trước ngày 13/05/2023. Địa chỉ: Số 09 Pasteur, phường Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Email: vattuivac@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.

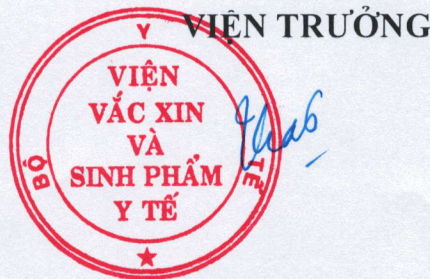

Dương Hữu Thái



PHỤ LỤC
DANH MỤC LỌC CẦN BÁO GIÁ

(Đính kèm Phiếu yêu cầu báo giá ngày 27/04/2023)

TT	Tên hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	<p>Màng lọc tiếp tuyến 30kDa, diện tích 0,5m²</p> <ul style="list-style-type: none">- Dạng màng lọc: Cassette- Kích thước NMWCO: 30 kDa- Diện tích trên màng lọc: 0.5 m²- Sản phẩm phải được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và ISO 9001- Chất liệu màng lọc:<ul style="list-style-type: none">+ Màng lọc: Composite Regenerated Cellulose (CRC)+ Màn (screen): Polypropylene+ Kết dính: Urethane- Màng lọc được phủ bằng lớp màn (screen) làm bằng Polypropylene dùng cho các mẫu protein đậm đặc hoặc dung dịch có độ nhớt cao (IgG, Biopolyme)- Màng lọc có cấu trúc không lỗ rỗng (void-free) để đảm bảo về độ lưu giữ và độ toàn vẹn- Áp suất xuyên màng theo chiều thuận (Forward TMP) tối đa phải lên đến 3.4 bar (50 psi) tại 30°C- Áp suất xuyên màng theo chiều ngược (Reverse TMP) phải đạt tối đa 0.33 bar (5 psi)- Khả năng bám dính IgG của màng lọc < 0.7ug/cm²- Thể tích làm việc tối thiểu < 175 mL/m²- Nhiệt độ vận hành: 0 - 30°C- pH: 2 - 13- Sản phẩm đã được đo lường và đảm bảo hiệu suất lưu giữ (Retention) bằng cách sử dụng hỗn hợp dextran nhiều chất hòa tan- Sản phẩm phải được kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng hoặc có chứng chỉ chất lượng sau:<ul style="list-style-type: none">+ Độ tinh theo USP <88>+ Mức độ thôi rữa (Extractable) ≤ 1500 mg/m² khi rửa với nước+ Đạt độ toàn vẹn màng lọc với lưu lượng ≤ 18 cc/phút tại 10 psi (690 mbar)+ Mức giảm áp suất từ 5 – 14 psi (300 – 970 mbar) tại tốc độ 0.8 gpm (3 L/phút)	08	cái
	YÊU CẦU KHÁC:		
	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ của hãng (nếu có)- Cung cấp đầy đủ giấy ủy quyền phân phối chính thức của hãng còn hiệu lực và Giấy phép bán hàng của hãng đối với các sản phẩm: lọc		